

Инструкция по эксплуатации

STRONG 209(A/B)/106

* Прочтите все инструкции перед использованием

Технические характеристики

Тип устройства:

Использование в стоматологической лаборатории.

Скорость вращения: 0 - 35.000 оборотов в минуту (35K)

Напряжение питания:

AC100-120V 50/60Гц 20W

AC220-230V 50/60Hz 20W

AC240V 50/60HZ 20w

Контроль скорости (209A)

On / Off педали (209B)

Вращательная способность: Правый/Левый

Автоматическая система защиты от перегрузки

(209A только)

Уникальная конструкция


Вертикальное / горизонтальное размещение

Пожалуйста, обеспечивайте, по крайней мере, 2-3 мм расстояние между острием наконечника и буром. Перед сменой бура, пожалуйста, установите переключатель скорости в положение «0». В противном случае, наконечник может быть поврежден.

ВНИМАНИЕ!

Если устройство не используется в течение более трех часов, не забудьте поставить блок питания в позицию "Off" (зеленая лампа должна быть выключена). В противном случае устройство может быть перегрето!


www.saeshin.com

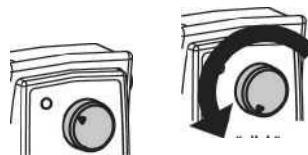

Описание товара

Этот продукт сконструирован для использования в стоматологии. Он предназначен преимущественно для клинического применения в стоматологической клинике. Также он может быть применен для дизайна ногтей, в сфере изготовления ювелирных изделий, для резьбы по дереву и литья.

Включение/выключение педали G

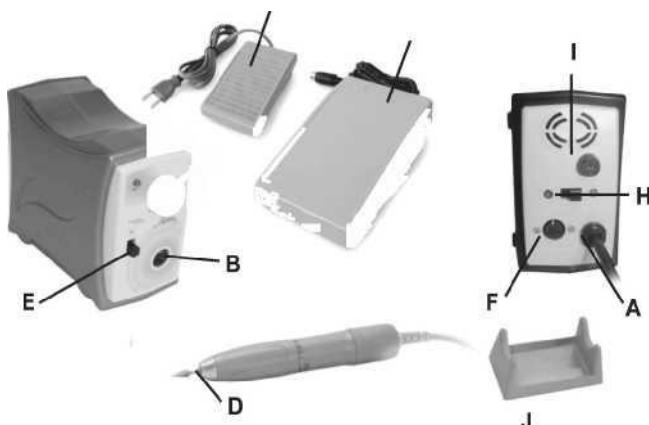

Контроль скорости педали G

- A. Шнур питания
- B. Разъем двигателя
- C. Переключатель питания и скорости вращения (On/Off)
- D. Патрон (открыто / закрыто)
- E. Переключатель (вперед/назад)
- F. Разъем педали
- G. Педаль
- H. Переключатель (ручной/ножной)
- I. Блок предохранителей
- J. Подставка для наконечника

Начало работы с устройством и его использование

1. Перед началом работы с устройством убедитесь, что переключатель (C) ("On/Off") находится в положении "Off" («выключено»).
2. Вставьте наконечник в гнездо (B) на основном блоке.
3. Установите скорость вращения аппарата (D) на "0".
4. Подключите шнур питания (A) к розетке.
5. Выберите бур и откройте патрон (D), повернув его против часовой стрелки. Поместите бур в открытый патрон (D) и заблокируйте его, поворачивая по часовой стрелке.
6. Убедитесь, что бур установлен правильно и что патрон надежно закреплен.
7. Выберите направление вращения (E): R - по часовой стрелке, L - против часовой стрелки.
8. Теперь, пользуясь переключателем контроля скорости вращения (C), установите режим необходимой скорости.
10. **ВАЖНО!** Перед тем как изменить направление вращения (E), очень важно сначала выключить блок, установив переключатель (C) в положение "Off".
11. **ВАЖНО!** Перед заменой бура также необходимо выключить блок, установив переключатель (C) в положение "Off" или установить регулятор скорости вращения (D) на "0".
12. Для подготовки педали к использованию ее следует подключить к разъему педали (F) на задней панели устройства. При этом "On/Off" переключатель (C) должен находиться в положении "Off" («выключено»). Теперь вы можете установить необходимую вам скорость вращения при помощи переключателя (C).

Теперь устройство готово к работе. Вы можете приводить его в движение и останавливать при помощи педали (G).

